NoiseKen®

取扱説明書

MODEL　06-00020A

株式会社 ノイズ研究所

第 1.01 **版**

AEC00148-001-0B

1. 目的

本製品は静電気試験器用放電ガン TC-814 に装着する 1000 pF のコンデンサユニットです。

2. 本体と添付品一式

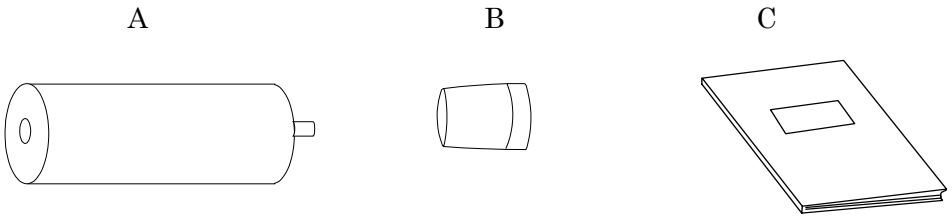

A：コンデンサユニット（1000 pF） ……1
B：コンデンサキャップ……1
C：取扱説明書 ……1

3. 装着方法

TC-814 の後部のコンデンサキャップを反時計方向に回して外し、既に装着されているコンデンサユニットを引き抜きます。本コンデンサユニットを突起がある面を奥にして差し込み、添付のコンデンサキャップを確実に取り付けます。

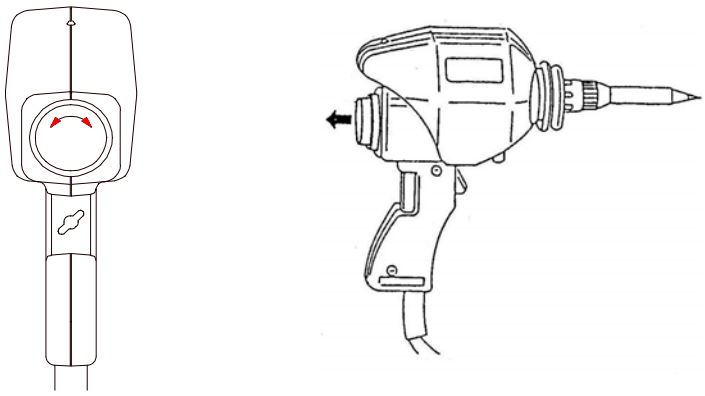

4. 仕様

項　目	仕　様
適合製品	TC-814
静電容量	1000 pF　± 20 %
最大印加電圧	20 kV

注　意

本コンデンサユニットの容量は比較的大きな 1000 pF の容量があり、TC-814 内部の放電リレーに大きな負担がかかります。高電圧で使用した場合、寿命の著しい低下、もしくは破壊する恐れがあります。従って本コンデンサユニットを装着したときは、20 kV 以下の電圧で使用してください。

※　安全のための注意事項、保証などに関する規定は、本体の取扱説明書に記載された内容に従ってください。

発行元　株式会社 ノイズ研究所

落丁・乱丁はお取り替えいたします。
PRINTED IN JAPAN